



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0007779

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ 541 выдан 12 октября 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Открытому акционерному обществу "Медтехника"

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя
ИНН 6317017565

443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 49

место нахождения (место жительства) заявителя

Открытое акционерное общество "Медтехника"

наименование

443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 49

адрес места (мест) осуществления деятельности

и удостоверяет, что

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

соответствует требованиям обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по аккредитован(о) поверке средств измерений;

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.


Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19 октября 2015 г.



Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

А.И. Литвак
инициалы, фамилия

подпись



Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____ от "____" _____ 20____ г. 060319
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Медтехника»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

443020, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 49

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

АЧГ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения давления, вакуумные измерения				
1	Манометры	ВПИ (0,4-0,6) МПа	КТ (1,5-2,5)	
2	Измерители артериального давления и пульса	(20-300) мм рт.ст. (40-180) мин ⁻¹	ПГ ± 3 мм рт.ст. ПГ ± 5 %	
3	Измерители артериального давления, сфигмоманометры	(20-300) мм рт.ст.	ПГ ± 3 мм рт.ст.	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
4	Анализаторы паров этанола	(0-475) мг/м ³ (475-950) мг/м ³ (0-240) мг/м ³ (240-950) мг/м ³	ПГ ± 47,5 мг/м ³ ПГ ± 10 % ПГ ± 48 мг/м ³ ПГ ± 20 %	
5	Анализаторы показателей гемостаза	(10-60) с (61-600) с (10-600) с	ПГ ± 1 с ПГ ± 2 с СКО < 0,4 с	

1	2	3	4	5
Измерения электрических и магнитных величин				
6	Амперметры постоянного тока	0,75 мА- 30 А	КТ (1,5-2,5)	
7	Вольтметры переменного тока	(75-600) В 50 Гц	КТ 2,5	
8	Вольтметры постоянного тока	(0,075-600) В	КТ (1,5-2,5)	
Радиоэлектронные измерения				
9	Электрокардиографы, электрокардиоскопы	(0,03-5) мВ ($2 \cdot 10^{-2}$ -75) Гц	ПГ $\pm$ (5-10) % ПГ $\pm$ (5-10) %	
Оптические и оптико-физические измерения				
10	Рефрактометры	(1,3-1,7) нм	ПГ $\pm 2 \cdot 10^{-4}$ нм	
11	Фотоэлектроколориметры	(0,1-100) % (Т) (315-980) нм	ПГ $\pm$ (0,5-1,5) % (Т) ПГ ± 3 нм	

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

М.П.



подпись уполномоченного лица

В.В. Дегтев

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации



Р.И. Клеменова


Технические эксперты



Н.В. Васецкая




Г.Б. Окопная



В.П. Пружина



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листа (ов) _____

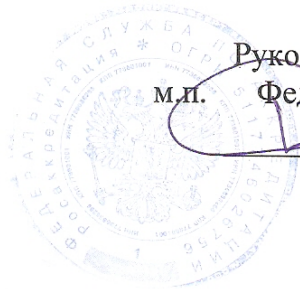

Руководитель (заместитель руководителя)
м.п. Федеральной службы по аккредитации

подпись

Д.А. МАКАРЕНКО
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от " " 20 60 г. 19
на 1 листах, лист 1

ДОПОЛНЕНИЕ №1
к ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Медтехника»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

443020, Россия, Самарская область, г.Самара, ул. Галактионовская, д. 49

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

АЧГ

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Дозаторы: -пипеточные -автоматические поршневые	(0,005-50) мл (0,2-10) мл	ПГ ± (1,0-5,0) % ПГ ± (1,0-2,5) %	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
2	Анализаторы паров этанола	(950-2000) мг/м³	ПГ ± 10 %	

Генеральный директор

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

В.В. Дегтев

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации




Р.И. Клеменова

Технические эксперты



Н.В. Васецкая



Г.Б. Окопная



В.П. Пружина